KS Medizintechnik seit 1921
Telefon: 0800 - 10 10 871
HIER GÜNSTIG KAUFEN
www.ksmedizintechnik.de

Abbott


CLEARVIEW®

STREP A CASSETTE 2 & STREP A DIPSTICK 2

DEUTLICH ANDERS. DEUTLICH BESSER.

Zwei Schnelltests für die direkte Detektion des Gruppe-A-Streptokokken-Antigens.

LABOR – HOCHWERTIGE ERGEBNISSE IN 5 MINUTEN.

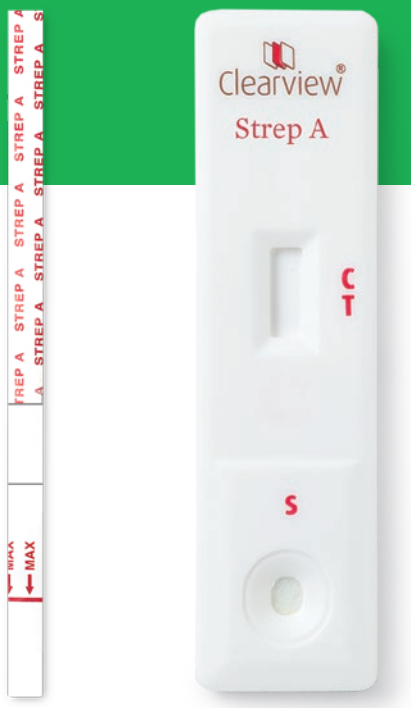

Unbehandelt können Infekte mit Streptokokken der Gruppe A zu schwerwiegenden Komplikationen führen, darunter rheumatisches Fieber und Peritonsillarabszesse.[1]

Eine frühzeitige Erkennung und Intervention bei einer durch Streptokokken der Gruppe A ausgelösten Pharyngitis ist besonders bei Kindern wichtig. Ein schnelles Erkennen der Infektionsursache kann:[2]

- den Krankheitsverlauf verkürzen.
- den Schweregrad der Symptome verringern.
- die Wahrscheinlichkeit von Komplikationen verringern.
- das Ansteckungsrisiko mindern.

Clearview® Strep A 2

EINFACHE ANWENDUNG*


1 4 Tropfen Reagenz A in ein Extraktionsröhrchen geben.



2
- 4 Tropfen Reagens B hinzugeben.
- Lösung durch Hin- und Herschwenken des Röhrchens vorsichtig mischen.



3
- Rachenabstrich sofort hinzufügen.
- Abstrich 10 Mal schwenken und 1 Minute im Röhrchen belassen.

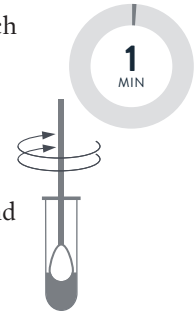


4
- Abstrich gegen die Röhrchenwand drücken.
- Röhrchen beim Herausziehen des Abstrichs zusammendrücken.
- Abstrich verwerfen.



5 **Teststäbchen** – Teststäbchen in das Extraktionsröhrchen geben.

Kassette – Extraktionsröhrchen verschließen und 3 Tropfen in die Probenvertiefung geben.



6 Ergebnis nach 5 Minuten ablesen.



Ergebnis nach 10 Minuten nicht mehr auswerten.

*Die vollständige Gebrauchsanweisung entnehmen Sie der Packungsbeilage.

EINFACH ZU LESEN



MERKMALE UND NUTZEN

Ergebnisse nach 5 Minuten	Schneller Antworten erhalten
Einfaches Verfahren	Einfache Eingliederung in den Arbeitsfluss
Klare Ergebnisse	Einfache Interpretation
Lagerung bei 2–30 °C	Mehr wertvoller Platz im Kühlschrank

TESTLEISTUNG

CLEARVIEW STREP A DIPSTICK 2	
Sensitivität	96,8 % (95 % KI = 92,0 %–99,1 %)
Spezifität	94,7 % (95 % KI = 91,9 %–96,7 %)
Präzision	95,2 % (95 % KI = 92,9 %–96,9 %)
CLEARVIEW STREP A CASSETTE 2	
Sensitivität	94,4 % (95 % KI = 88,3 %–97,9 %)
Spezifität	98,2 % (95 % KI = 96,3 %–99,3 %)
Präzision	97,4 % (95 % KI = 95,5 %–98,6 %)

BESTELLINFORMATIONEN

CLEARVIEW STREP A DIPSTICK 2	
Kit mit 25 Tests	Kat. Nr. IST-501
CLEARVIEW STREP A CASSETTE 2	
Kit mit 25 Tests	Kat. Nr. IST-502

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI IHREM LOKALEN ABBOTT-VERTRETER ODER BESUCHEN SIE NOCH HEUTE GLOBALPOINTOFCARE.ABBOTT.

1. Webb, KH. Does Culture Confirmation of High-sensitivity Rapid Streptococcal Tests Make Sense? A Medical Decision Analysis. Pediatrics (Feb 1998), 101:2, 2.
2. Shulman, S.T. *et al.* Clinical Practice Guideline for the Diagnosis and Management of Group A Streptococcal Pharyngitis: 2012 Update by the Infectious Diseases Society of America.

© 2022 Abbott. Alle Rechte vorbehalten. Alle genannten Marken sind entweder Marken der Abbott-Unternehmensgruppe oder ihrer jeweiligen Eigentümer. Die hier gezeigten Abbildungen dienen nur zu illustrativen Zwecken. COL-05378-03 03/22

Abbott